



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 电字第 3146077 号

Certificate No.

委 托 单 位 铁岭恒安电力检修工程有限公司
Applicant

计 量 器 具 名 称 避雷器计数器动作测试仪
Name of Instrument

型 号 / 规 格 FS3012
Type/Specification

出 厂 编 号 1412359
Serial No.

制 造 单 位 武汉世纪华胜科技有限公司
Manufacturer


校 准 依 据 参照 JJG124-2005
Calibration Regulation



批准人 贾 模
Approved by _____

核验员 王 荣
Checked by _____


校准员 王 斌
Calibrated by _____



校 准 日 期 2014 年 12 月 22 日
Date of Calibration Year Month Day

计量检定机构授权证书号: (鄂)法计(2013)A001号
Authorization Certificate No.
地址: 湖北省武汉市江堤中路 28 号
Address
传真: (027) 84825873
Fax

电话: (027) 84846917, 84825873
Telephone
邮编: 430050
Post Code
电子邮件: jls@whbts.gov.cn
Email



武汉市计量测试检定(研究)所


WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 电字第 3146077 号
Certificate No.

- 本所是国家法定计量检定机构, 授权证书号: (鄂)法计(2013)A001号
This body is an institute of legal verification, Authorization certificate No: (鄂)法计(2013)A001号

- 本次校准所使用的主要计量标准器
Standards of measurement used in the Calibration

名称 Name	证书编号 Certification No	有效期 Valid date to
数字多用表	电字第 1147025 号	2015-09-11

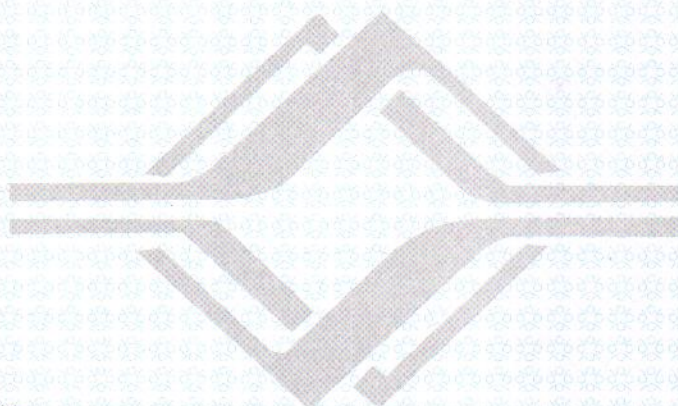

- 校准环境条件
Environmental condition on the Calibration

温度: 19 °C 湿度: 51 %RH 其它: —
Temperature Humidity Others

地点: 公司车间
Place

w141223013

本证书未加盖本所业务专用章无效, 部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效。
This certificate shall not be reproduced (except in full), without the written approval of the institute



证书编号: 电字第 3146077 号
Certificate No.

校准结果

一、外观及工作正常性检查:
正常。

二、电压试验: (AC)

示值(V)	实测值(V)
20	20.07
40	40.19
80	80.26
120	120.33
160	160.29
200	201.81

测量结果的不确定度: $U_{rel}=0.17\%$ $k=2$

三、电流试验:

示值(mA)	实测值(mA)
0.5	0.503
1	1.005
2	2.014
5	5.042

测量结果的不确定度: $U_{rel}=0.3\%$ $k=2$

以下空白

